

RAPPORT D'EXPERTISE



Bureau d'Expertise et R&D en Biophotonique

biophotex@gmail.com

ETUDE SCIENTIFIQUE

**Approche innovante, combinant la Biophotonique
et la Médecine Traditionnelle Chinoise, pour soutenir la santé globale.**

Evaluation en Biophotonique (imagerie électrophotonique) avec la caméra GDV2 Bio-Well, de l'action du disque cymatique « Cyma-Seat » sur les méridiens d'acupuncture (MTC), en position assise.

- Démontrer l'efficacité de l'action du disque cymatique « Cyma-Seat » sur l'équilibre fonctionnel des 12 méridiens d'acupuncture.
- Démontrer l'efficacité de l'action de l'action du disque cymatique « Cyma-Seat » sur l'équilibre du SNA et des systèmes fonctionnels du corps humains.

CONCLUSION

Les résultats de cette étude scientifique mettent en évidence une corrélation entre l'amélioration des pourcentages d'équilibre des méridiens d'acupuncture (MTC) et l'amélioration des pourcentages d'équilibre du SNA et des Systèmes Fonctionnels du corps humain.

L'utilisation du disque cymatique « Cyma-Seat » vise à harmoniser l'énergie du corps en agissant à la fois sur le pourcentage d'équilibre énergétique des méridiens d'acupuncture (systèmes énergétiques traditionnels) et des Systèmes Fonctionnels du corps humain, favorisant une interaction synergique entre ces deux systèmes.

Cette approche favorise une régulation énergétique et une santé globale optimales, offrant des bénéfices significatifs tant sur le plan physique qu'émotionnel.

Michel ETILE

Expert Universitaire en Biophotonique

LA BIOPHOTONIQUE

La Biophotonique, est une méthode scientifique de mesure de l'énergie vitale organique (ATP Mitochondrial) utilisée avec succès dans soixante-deux pays.

L'effet se produit lorsqu'un objet est placé sur une plaque de verre et stimulé par un courant ; une lueur visible apparaît, la décharge gazeuse. Avec les caméras de bio électrographie EPI, l'effet Kirlian est quantifiable et reproductible à des fins de recherche scientifique. Les images capturées (Bio-grammes) des dix doigts de chaque sujet humain fournissent des informations détaillées sur l'état psychophysiologique et organique de la personne. En examinant les images fluorescentes du bout des doigts, qui changent dynamiquement en fonction des états de santé, on peut identifier les zones de congestion ou de santé dans l'ensemble des systèmes fonctionnels du corps humain. Chaque photographie de bout de doigt générée est analysée par division sectorielle, selon les méridiens d'acupuncture. Le Dr Peter Mandel, en Allemagne, et le Dr Voll ont mis au point, au cours de plusieurs décennies, cette méthode complexe et bien définie.

En outre, chez la plupart des personnes en bonne santé, les résultats ne varient que de 8 à 10 % sur plusieurs années de mesures, ce qui indique un niveau de précision élevé avec cette technique. Un logiciel complexe enregistre ces mesures en paramètres qui permettent d'élucider l'état de santé de la personne au moment des mesures.

APPAREIL DE MESURE EN BIOPHOTONIQUE

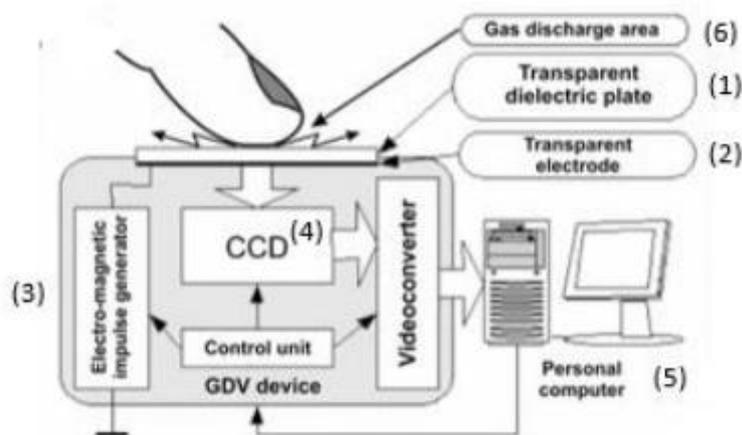


Schéma de la caméra GDV

Principes physiques de la caméra GDV Bio-Well

Il y a une électrode en verre, une plaque diélectrique transparente (1) sous laquelle il y a une électrode transparente (2) qui est une couche conductrice à laquelle les impulsions de hautes tensions sont envoyées par le générateur d'impulsions électromagnétiques (3) qui se trouve à

l'intérieur du dispositif GDV. La lueur qui est créée dans l'air est photographiée par la caméra vidéo (4) et ensuite transformée sous forme d'images numériques à l'ordinateur (5). L'émission d'électrons négatifs et de protons positifs produit par le champ électrique puissant crée une avalanche électronique dite « décharge corona » (6), d'où cette émission de lumière (lueur) que la caméra enregistre. La caméra vidéo photographie la décharge couronne créée par le flux électronique de la matière, en l'occurrence ici le doigt du sujet étudié.

Cette technique d'imagerie électro-photonique est non invasive et utilisée pour évaluer l'état fonctionnel du corps humain en enregistrant la réponse du système nerveux autonome à un champ électromagnétique (CEM) de haute intensité. Ce CEM est créé en utilisant un analyseur d'impulsions électro-photonique pour mesurer la conductance électrique du tissu du bout des doigts. Selon la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise et de l'acupuncture Su-Jok, les secteurs du bout des doigts correspondent à des systèmes physiologiques spécifiques dont **nous mesurerons l'énergie en unités joules (10^{-2}) pour évaluer l'état fonctionnel des organes et des systèmes.**

Le « Cyma-Seat »

Grand Disque Cymatique à placer sur une chaise, un fauteuil ou un canapé.

Face interne



Face Externe



* « S'asseoir sur cette face »

Les fréquences externes et internes sont comprises entre 50 Hz et 400Hz

Liste des méridiens d'acupuncture impactés par l'action du disque « Cyma-Seat », en position assise.

- Méridien de la Vessie (V30, V36, V37 et V40)
- Méridien du Rein (Rn1)
- Méridien du Foie (F8, F11 et F12)
- Méridien de la Rate (Rt6, Rt9 et Rt12)
- Méridien de l'Estomac (E30, E31 et E34)
- Méridien de la Vésicule Biliaire (VB30, VB31 et VB34)
- Méridien du Gouverneur (du mai) (VG1, VG2 et VG3)
- Méridien de Conception (ren mai) (VC3, VC4 et VC6)

EFFETS ATTENDUS :

- **Harmonisation énergétique du bassin** : les points mentionnés présentent un équilibre énergétique dans la région pelvienne, souvent considéré comme un centre d'énergie vitale en médecine traditionnelle chinoise (*proche du concept de dan tian inférieur*).
- **Activation des méridiens majeurs** : notamment vessie, conception, gouverneur et pénétrant, qui traverse ces zones.
- **Activation de la circulation sanguine et énergétique** : les vibrations peuvent améliorer la microcirculation et dynamiser les flux d'énergie subtile.

CONDITIONS POUR UNE STIMULATION OPTIMALE :

Calibrage des fréquences cymatiques : fréquences favorisant l'harmonisation de l'énergie Vitale Mitochondriale (ATP) et la relaxation. La fréquence de la face interne du disque est comprise entre 50Hz et 100Hz et la fréquence de la face externe entre 300Hz et 400Hz

Diamètre du Disque = 22,5 cm (14 fois Phi, le nombre d'Or)

Position correcte : S'asseoir sur la face INTERNE du disque de manière à ce que les vibrations soient réparties uniformément sur la zone du bassin.

Durée de la séance : 60 minutes.

METHODOLOGIE :

Pour chaque cas étudié : Avant et Après 1H assis sur le « Cyma-Seat » :

- Mesure des pourcentages d'équilibre et de l'énergie des 12 Méridiens d'acupuncture.
- Mesure des pourcentages d'équilibres du Système Nerveux Autonome (SNA) dans tous les systèmes fonctionnels du corps humain.
- Mesure des pourcentages d'équilibre et de l'énergie des 9 systèmes fonctionnels du corps humain (Tête, système Cardio-vasculaire, système Endocrinien, système Digestif, système Respiratoire, système Musculosquelettique, système Génito-urinaire, système Nerveux Central (SNC), système Immunitaire). Energie vitale mesurée en unité Joule (10^{-2}).

Soit : 244 paramètres analysés pour chaque mesure « Avant/Après ».

CONCLUSIONS

Une exposition d'une heure au disque cymatique « Cyma-Seat » induit une augmentation significative et mesurable des pourcentages d'équilibre des 12 méridiens d'acupuncture (MTC), qui atteignent des valeurs comprises entre 90 % et 100 %. Cette harmonisation traduit un état énergétique optimal, essentiel en médecine traditionnelle chinoise (MTC) pour assurer la circulation fluide du Qi (énergie vitale) et du sang, prévenant ainsi les déséquilibres pathologiques.

L'effet harmonisant du « Cyma-Seat » se manifeste également au niveau des Systèmes Fonctionnels du corps humain. En alignant les énergies des méridiens avec des valeurs normatives (4 à 6 Joules $\times 10^{-2}$), il réduit les excès énergétiques dans les méridiens ou systèmes fonctionnels dépassant 6 Joules (10^{-2}), tout en maintenant ou optimisant les niveaux énergétiques inférieurs. Cette régulation contribue à une répartition homogène et équilibrée de l'énergie à travers les différentes structures physiologiques.

Le « Cyma-Seat » influence bénéfiquement l'équilibre énergétique et son impact sur le SNA et les systèmes fonctionnels du corps humain.

Avantages pour la santé induits par l'exposition au disque cymatique « Cyma-Seat »

1. Harmonisation énergétique des méridiens :

L'exposition d'une heure au « Cyma-Seat » favorise une redistribution équilibrée du Qi (énergie vitale) à travers les méridiens d'acupuncture. Cette harmonisation réduit les excès d'énergie dans les méridiens où les valeurs dépassent 6 Joules (10^{-2}), les ramenant dans une fourchette optimale de 4 à 6 Joules (10^{-2}), conforme aux normes énergétiques. Cette harmonisation est essentielle pour prévenir les déséquilibres pathologiques et maintenir une santé globale.

2. Augmentation des pourcentages d'équilibre fonctionnel :

Les pourcentages d'équilibre des méridiens atteignant des niveaux compris entre 90 % et 100 % traduisent une quasi-parfaite harmonie énergétique. Cela assure le bon fonctionnement des organes et des Systèmes Fonctionnels. Une telle augmentation est particulièrement bénéfique pour maintenir une vitalité optimale et prévenir les dysfonctionnements énergétiques.

3. Amélioration du Système Nerveux Autonome (SNA) :

Bien que les niveaux d'énergie mesurés ne varient pas de manière statistiquement significative, l'augmentation des pourcentages d'équilibre fonctionnel des méridiens a un impact indirect sur le SNA.

4. Réduction du stress et amélioration du bien-être émotionnel :

L'équilibre énergétique des méridiens agit positivement sur la régulation des émotions, notamment en réduisant les tensions nerveuses et en favorisant un état de relaxation. Les méridiens tels que le Cœur et le Foie, souvent impliqués dans la gestion du stress, bénéficient particulièrement de cette harmonisation.

5. Renforcement de la santé globale :

Une harmonisation énergétique globale des Méridiens et des Systèmes Fonctionnels du corps humain contribue à une meilleure résistance immunitaire, à une gestion optimisée des ressources énergétiques du corps, et à une vitalité accrue.

Ce rééquilibrage énergétique, couplé à une meilleure régulation du SNA, favorise un état de santé optimal, réduisant les risques de déséquilibres chroniques et améliorant la qualité de vie.

ANALYSE DES RESULTATS



Rappel

- 244 paramètres analysés pour chaque mesure « Avant/Après ».
- **Chaque cas a été mesuré 3 fois « Avant/Après » sur trois jours différents, espacés d'au moins 2 jours.**

L'analyse des résultats étudie la moyenne de toutes les mesures prises pendant les 3 jours de tests.

Pour chaque cas, le tableau récapitulatif présenté dans cette étude contient les moyennes des 732 paramètres étudiés dans le cadre de cette étude scientifique en Biophotonique.

Soit 465 paramètres à analyser pour les 3 mesures « Avant/Après » :

- Pour les 12 Méridiens d'acupuncture : 72 mesures des énergies + 72 mesures des pourcentages d'équilibre.
- Pour les 9 Systèmes Fonctionnels du corps Humain : 54 mesures concernant les pourcentages d'équilibre.
- Pour les 40 Organes : 240 mesures énergétiques.
- Pour le Système Nerveux Autonome (SNA) : 196 mesures des pourcentages d'équilibre. *(Ce système contrôle le fonctionnement de tous les organes et des systèmes fonctionnels du corps humain)*

I) Cas N°1

Mesures Décembre 2024

Mesures énergétiques en unités Joules (10^{-2}) des 12 Méridiens (MTC).

Norme = entre 4 et 6 joules (10^{-2})

Mesures du pourcentage d'équilibre des 12 Méridiens (action du SNA).

Norme optimale = entre 90% et 100%

A) Analyse de l'action du « Cyma-Seat » sur l'énergie et le pourcentage d'équilibre des 12 Méridiens d'acupuncture


Rappel: Le tableau récapitulatif présenté dans cette étude contient les moyennes des 732 paramètres étudiés dans le cadre de cette étude scientifique

Mesures Méridiens	AVANT Energie en Joules (10^{-2})	1H APRES Energie en Joules (10^{-2})	AVANT Pourcentage équilibre	1H APRES Pourcentage équilibre
YIN				
Poumons	5,36	5,18	89%	100%
Rate	5,39	5,23	84%	99%
Cœur	5,49	5,48	89%	93%
Reins	5,77	5,63	90%	95%
Péricarde	5,39	5,46	85%	93%
Foie	5,97	5,90	74%	96%
YANG				
Gros Intestin	5,56	5,40	79%	87%
Estomac	* 6,09	*5,91	-	-
Intestin Grêle	5,21	5,72	84%	94%
Vessie	*6,64	*5,01	76%	90%
Triple Réchauffeur	5,31	5,01	92%	97%
Vésicule Biliaire	5,55	5,33	-	-

**** = harmonisation de l'énergie qui était en augmentation dans la Vessie et l'Estomac.**


Energie : Les méridiens d'acupuncture conserve statistiquement une énergie équivalente avant et après 1H d'utilisation du Cyma-Seat en position assise.

L'action des fréquences du disque « Cyma-Seat » fait augmenter les pourcentages d'équilibre fonctionnels des méridiens, favorisant l'harmonisation de l'énergie du corps en agissant sur l'équilibre énergétique des méridiens d'acupuncture.

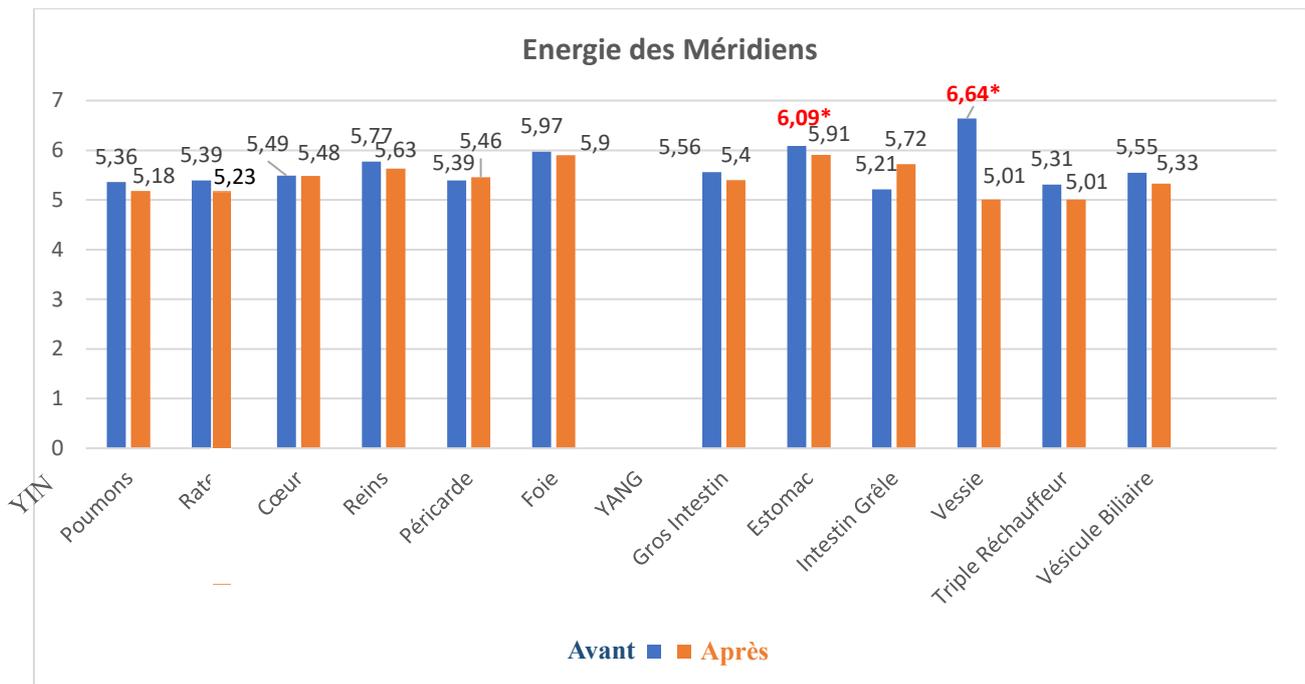


* = harmonisation de l'énergie qui était en augmentation dans l'Estomac et la Vessie.

Energie : Les Méridiens d'acupuncture conservent statistiquement une énergie équivalente avant et après avoir été assis 1H sur le disque « Cyma-Seat ».

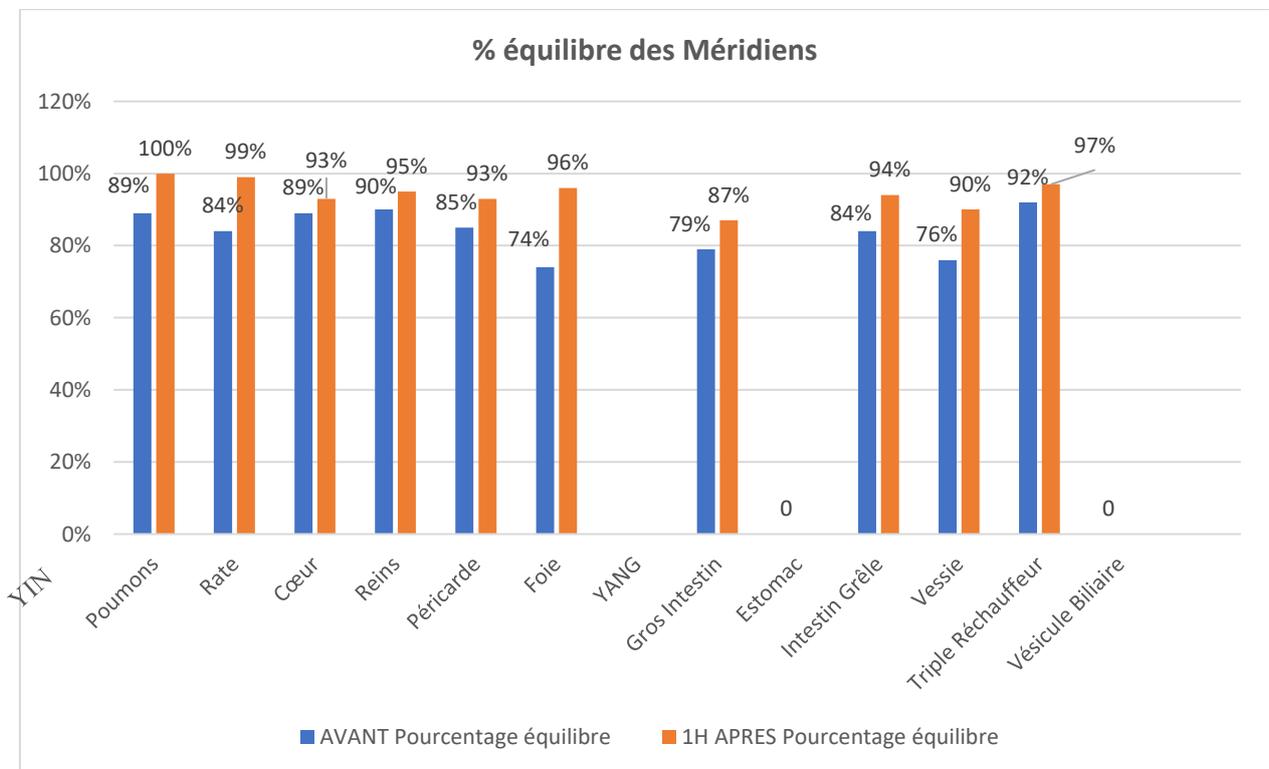


L'action des fréquences du disque « Cyma-Seat » fait augmenter statistiquement tous les pourcentages d'équilibre des méridiens, favorisant l'harmonisation de l'énergie du corps en agissant sur l'équilibre énergétique des méridiens d'acupuncture.

B) Analyse de l'action du « Cyma-Seat » sur l'énergie et le pourcentage d'équilibre des Systèmes Fonctionnels du corps humain

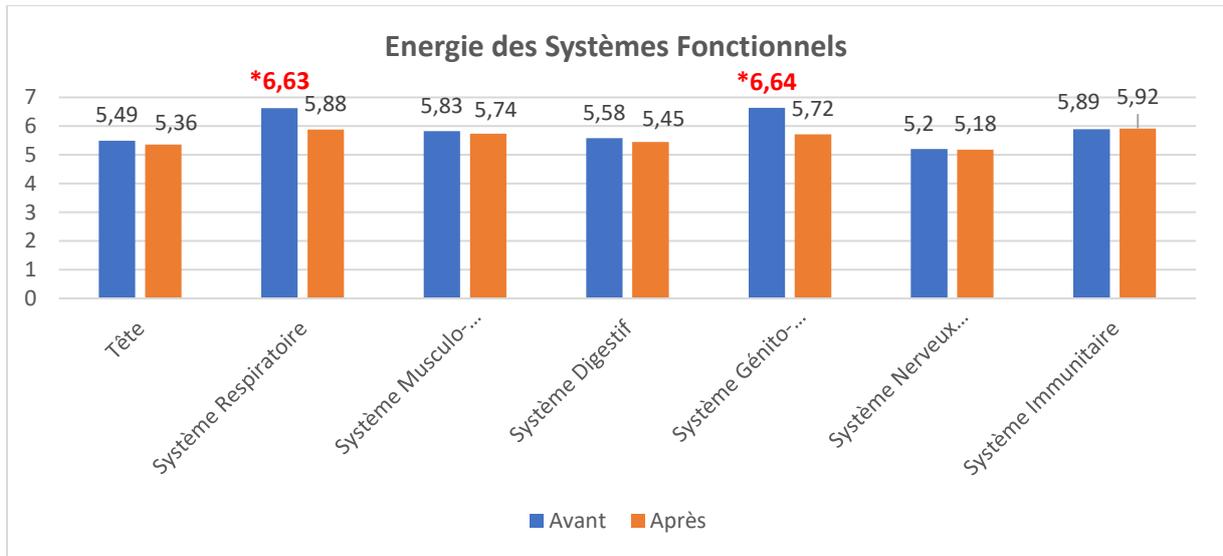

* = harmonisation de l'énergie qui était en augmentation dans le système Respiratoire et le système Génito-Urinaire.

Energie : Les Systèmes Fonctionnels conservent statistiquement une énergie équivalente avant et après avoir été assis 1H sur le disque « Cyma-Seat ».

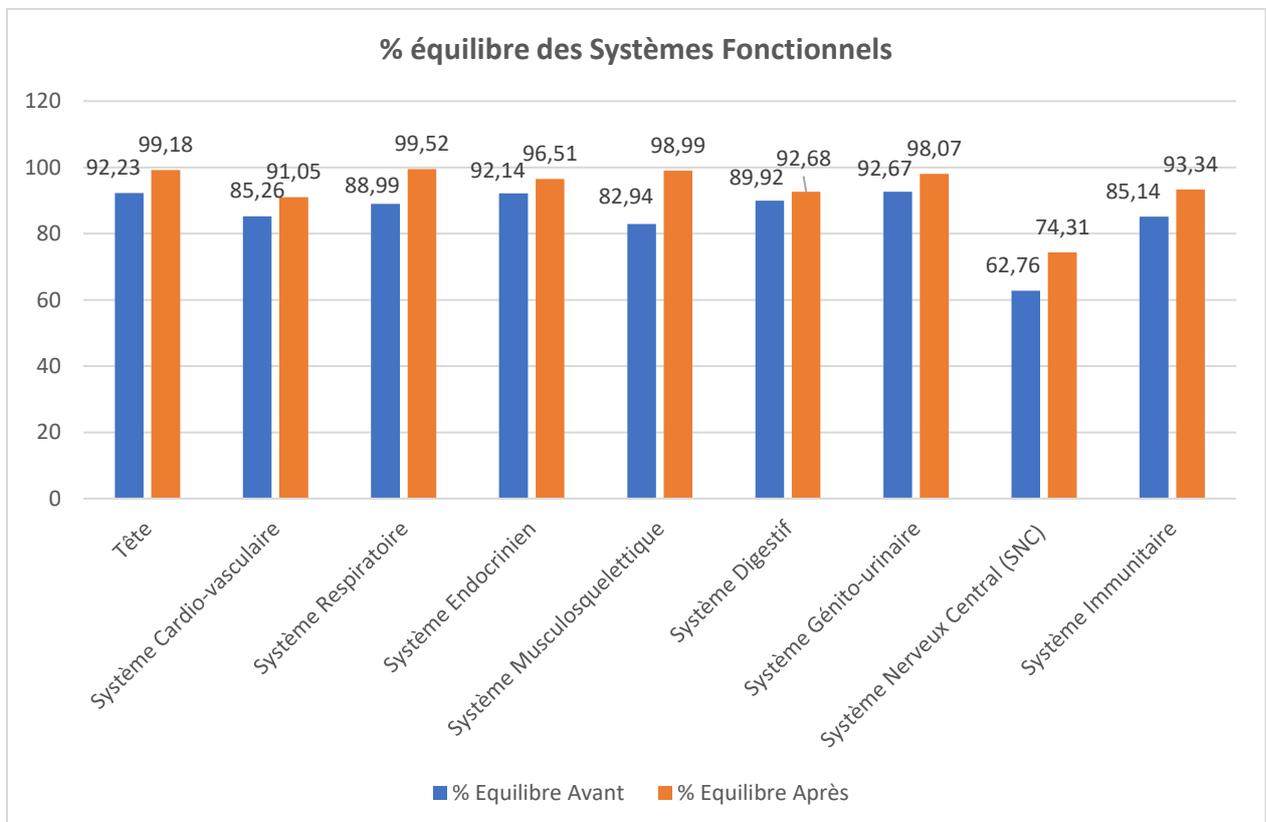

L'action des fréquences du disque « Cyma-Seat » fait augmenter statistiquement tous les pourcentages d'équilibre dans les Systèmes Fonctionnels, favorisant l'harmonisation énergétique organique globale.

II) Cas N° 2

Mesures Décembre 2024

Mesures énergétiques en unités Joules (10^{-2}) des 12 Méridiens (MTC).

Norme = entre 4 et 6 joules (10^{-2})

Mesures du pourcentage d'équilibre des 12 Méridiens (action du SNA).

Norme optimale = entre 90% et 100%


A) Analyse de l'action du « Cyma-Seat » sur l'énergie et le pourcentage d'équilibre des 12 Méridiens d'acupuncture

Rappel: Le tableau récapitulatif présenté dans cette étude contient les moyennes des 732 paramètres étudiés dans le cadre de cette étude scientifique.


Mesures Méridiens	AVANT Energie en Joules (10^{-2})	1H APRES Energie en Joules (10^{-2})	AVANT Pourcentage équilibre	1H APRES Pourcentage équilibre
YIN				
Poumons	4,57	4,44	86%	90%
Rate	4,34	4,41	87%	93%
Cœur	5,12	4,92	89%	91%
Reins	4,79	4,51	88%	98%
Péricarde	4,57	4,63	98%	98%
Foie	5,24	4,93	86%	92%
YANG				
Gros Intestin	5,83	5,66	78%	92%
Estomac	5,19	5,33	-	-
Intestin Grêle	5,22	5,06	91%	95%
Vessie	4,91	5,02	84%	95%
Triple Réchauffeur	5,59	5,82	98%	99%
Vésicule Biliaire	4,63	4,94	-	-

Energie : Les méridiens d'acupuncture conserve statistiquement une énergie équivalente avant et après avoir été assis 1H sur le disque « Cyma-Seat ».

L'action du disque « Cyma-Seat » est ciblée sur l'augmentation des pourcentages d'équilibre fonctionnels des méridiens.

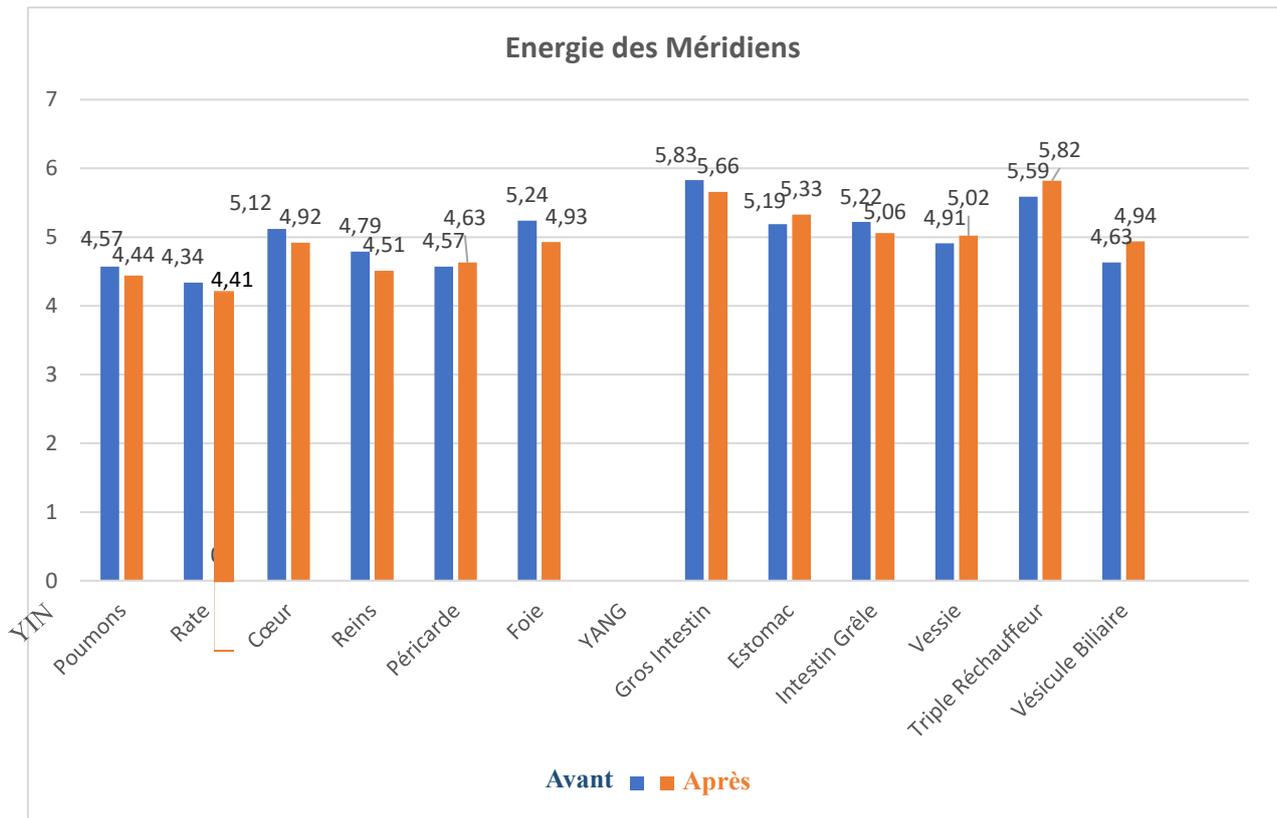


Energie : Les méridiens d’acupuncture conserve statistiquement une énergie équivalente avant et après 1H d’utilisation du « Cyma-Seat » en position assise.

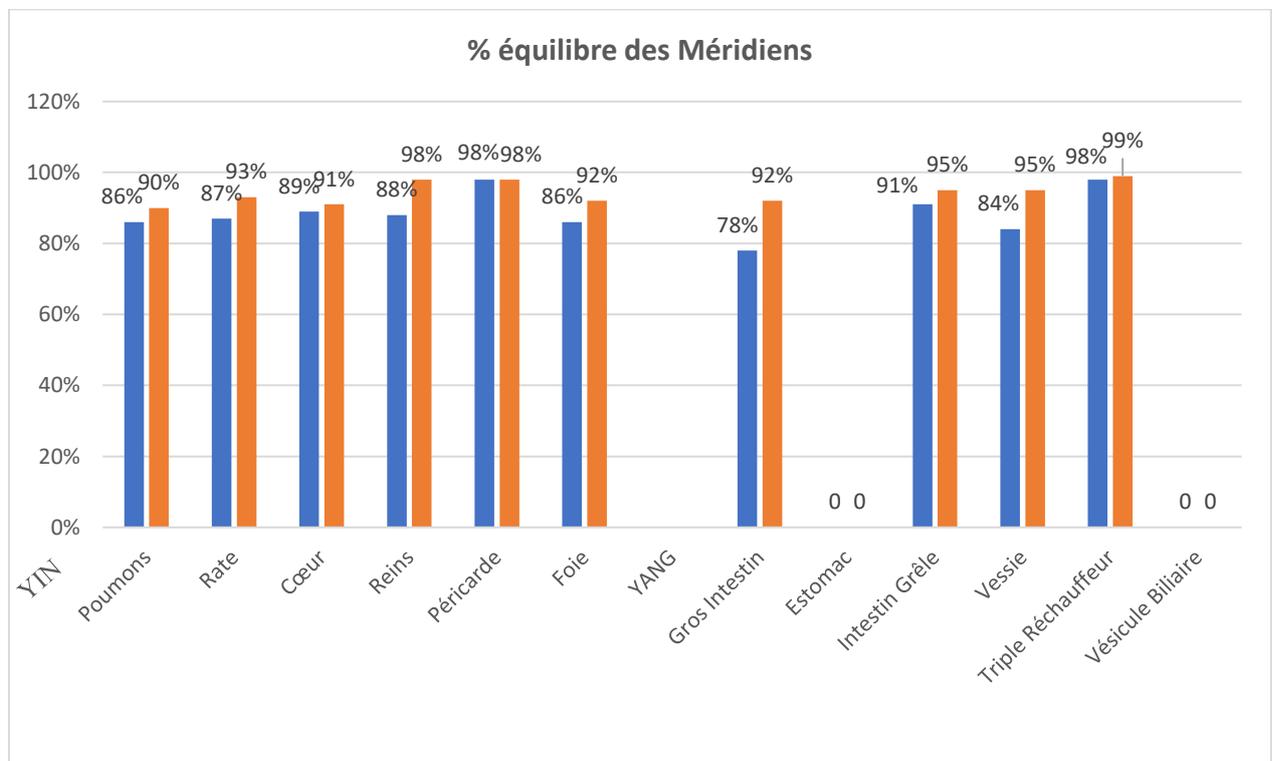


L’action des fréquences du disque « Cyma-Seat » fait augmenter statistiquement tous les pourcentages d’équilibre des Méridiens, favorisant l’harmonisation énergétique globale.

B) Analyse de l'action du « Cyma-Seat » sur l'énergie et le pourcentage d'équilibre des Systèmes Fonctionnels du corps humain

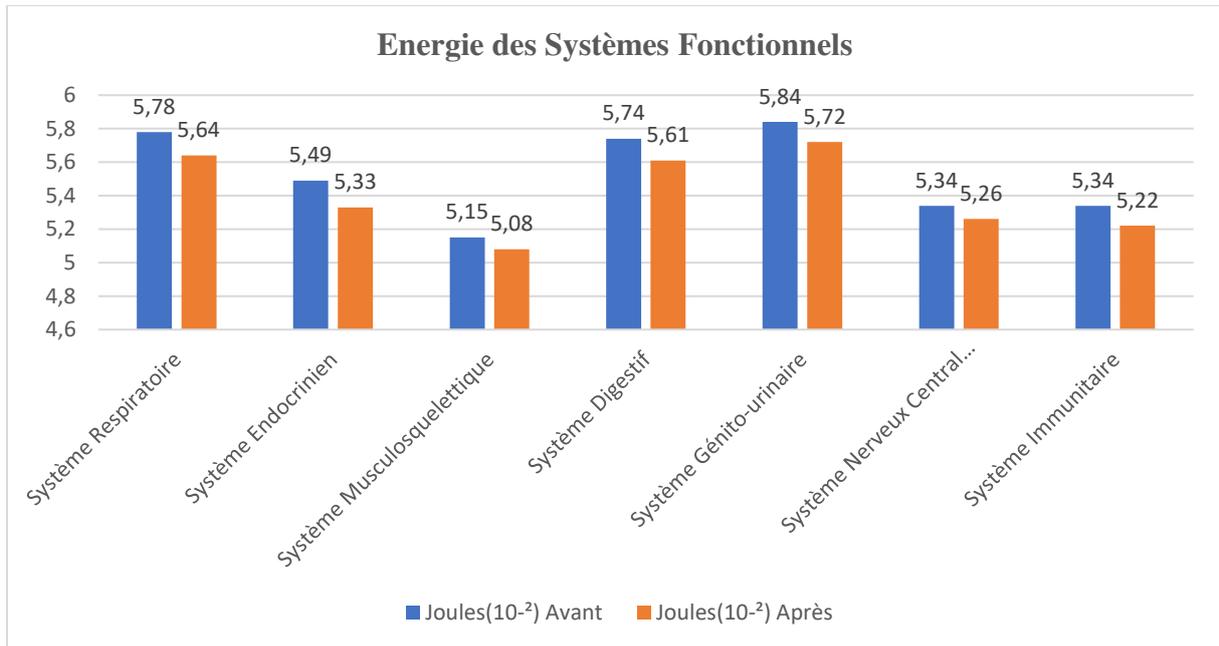

Energie : Les Systèmes Fonctionnels conservent statistiquement une énergie équivalente avant et après avoir été assis 1H sur le disque « Cyma-Seat ».

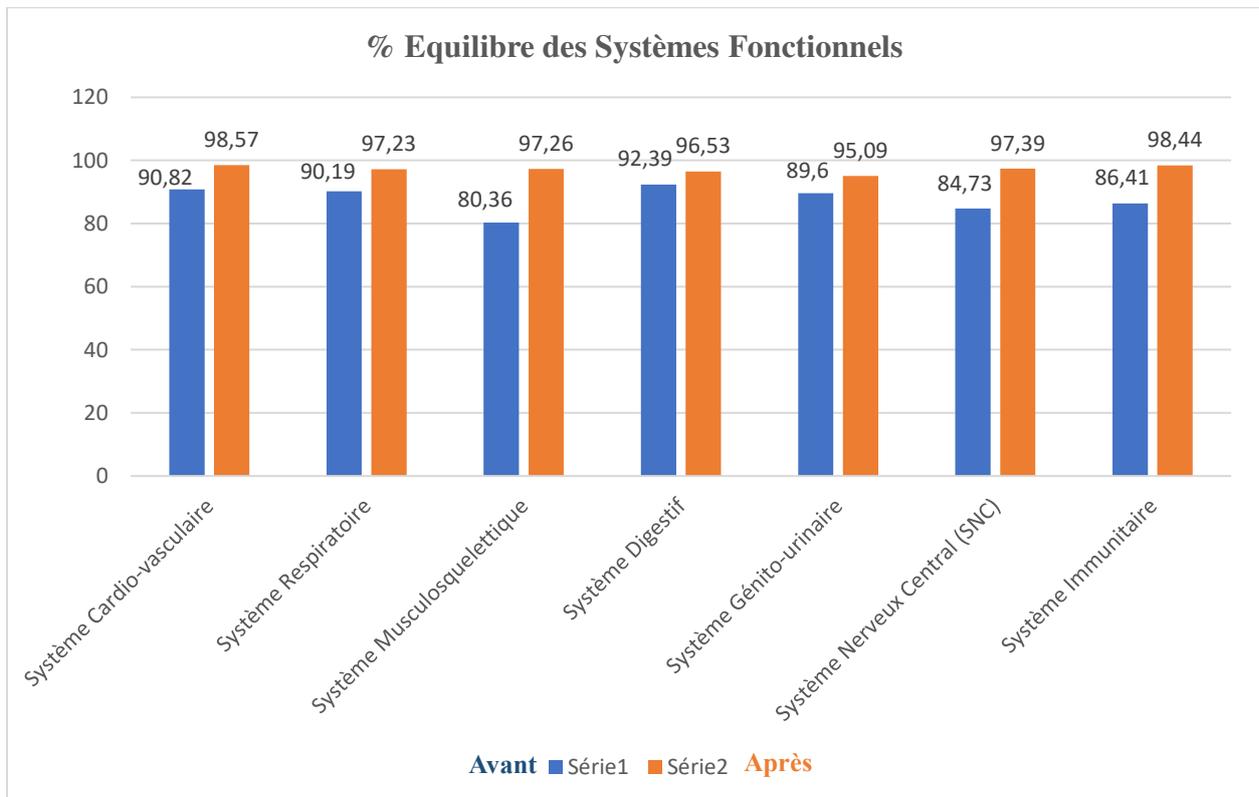

L'action des fréquences du disque « Cyma-Seat » fait augmenter statistiquement tous les pourcentages d'équilibre dans les Systèmes Fonctionnels, favorisant l'harmonisation énergétique organique globale.

III) Cas N° 3

Mesures Décembre 2024

Mesures énergétiques en unités Joules (10^{-2}) des 12 Méridiens (MTC).

Norme = entre 4 et 6 joules (10^{-2})

Mesures du pourcentage d'équilibre des 12 Méridiens (action du SNA).

Norme optimale = entre 90% et 100%

A) Analyse de l'action du « Cyma-Seat » sur l'énergie et le pourcentage d'équilibre des 12 Méridiens d'acupuncture


Rappel: Le tableau récapitulatif présenté dans cette étude contient les moyennes des 732 paramètres étudiés dans le cadre de cette étude scientifique.

Mesures Méridiens	AVANT Energie en Joules (10^{-2})	1H APRES Energie en Joules (10^{-2})	AVANT Pourcentage équilibre	1H APRES Pourcentage équilibre
YIN				
Poumons	4,87	4,61	93%	100%
Rate	5,34	5,05	90%	97%
Cœur	4,90	4,95	86%	97%
Reins	5,48	5,31	84%	98%
Péricarde	4,99	5,13	79%	92%
Foie	5,20	5,07	85%	94%
YANG				
Gros Intestin	5,13	4,97	84%	96%
Estomac	4,66	4,46	-	-
Intestin Grêle	4,84	4,58	87%	96%
Vessie	*6,40	*5,16	83%	99%
Triple Réchauffeur	5,31	5,11	90%	99%
Vésicule Biliaire	4,84	4,66	-	-

**** = harmonisation de l'énergie qui était en augmentation dans la Vessie.**


Energie : Les méridiens d'acupuncture conserve statistiquement une énergie équivalente avant et après traitement.

L'action du disque « Cyma-Seat » est ciblée sur l'augmentation des pourcentages d'équilibre fonctionnels des méridiens.

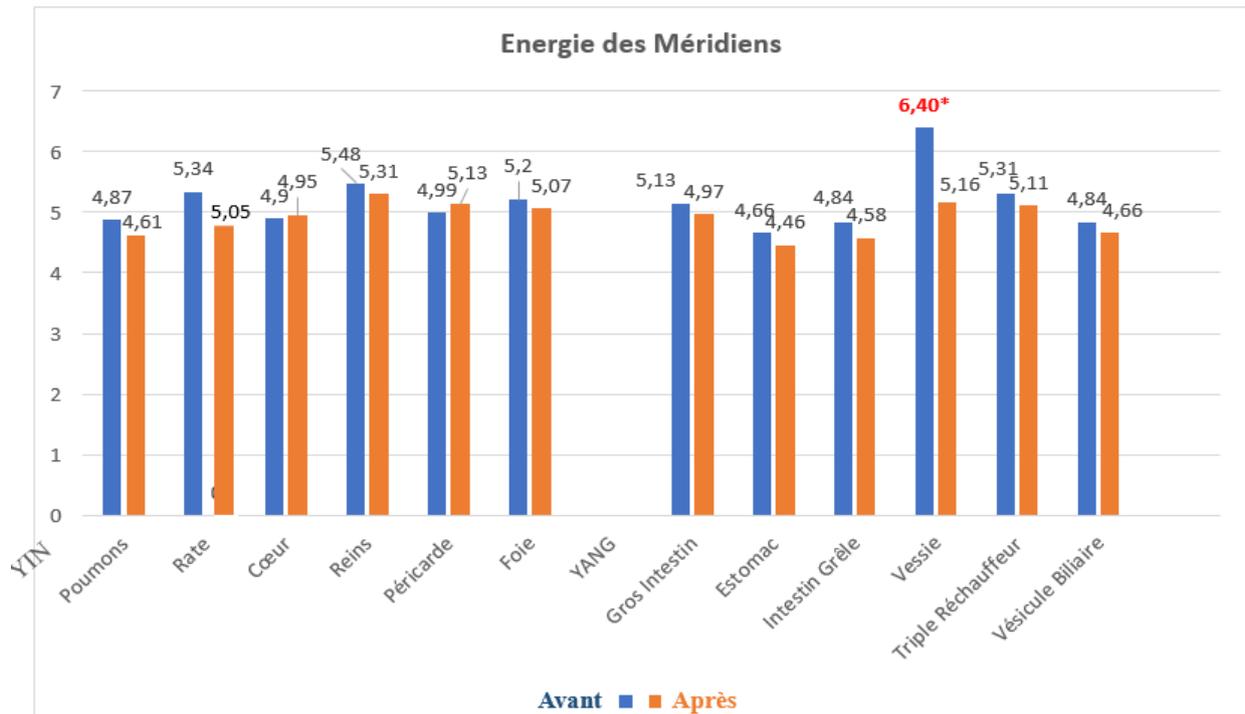


* = harmonisation de l'énergie qui était en augmentation dans la Vessie.

Energie : Les méridiens d'acupuncture conserve statistiquement une énergie équivalente avant et après 1H d'utilisation du « Cyma-Seat » en position assise.

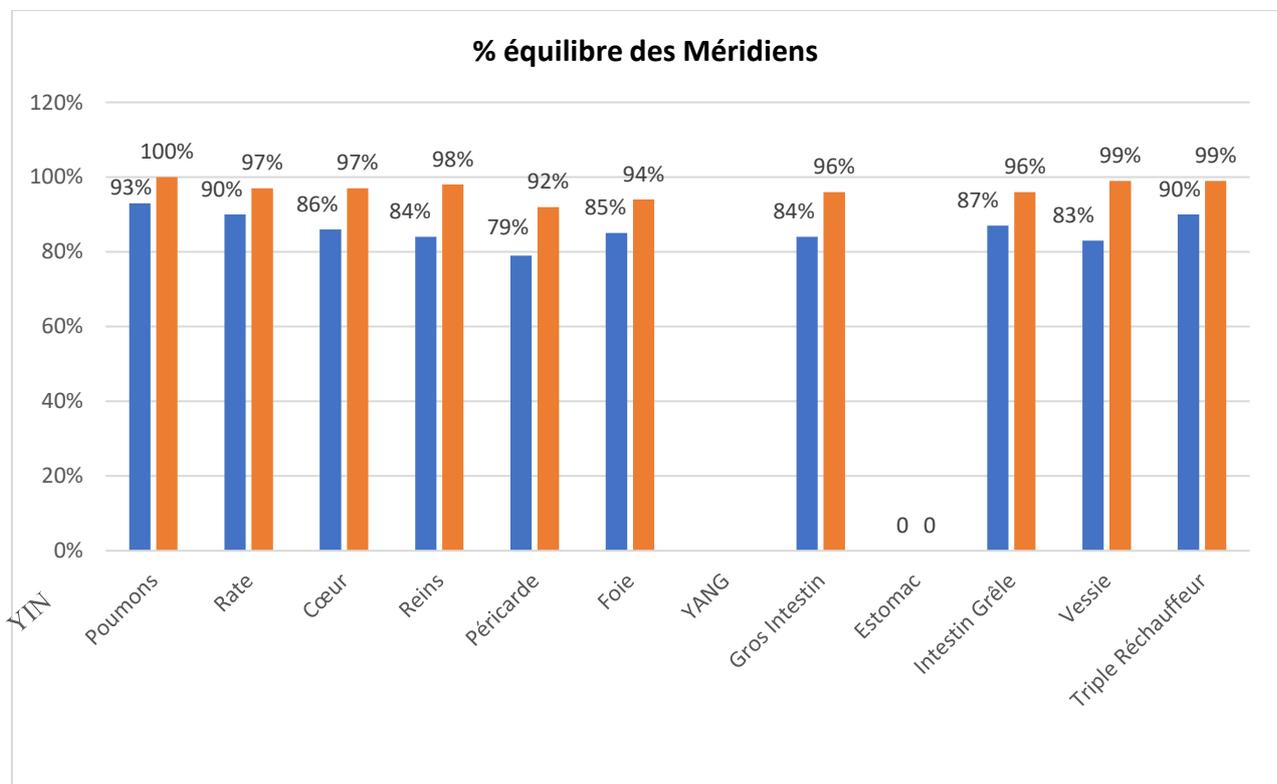


L'action des fréquences du disque « Cyma-Seat » fait augmenter statistiquement tous les pourcentages d'équilibre des Méridiens, favorisant l'harmonisation énergétique globale.

B) Analyse de l'action du « Cyma-Seat » sur l'énergie et le pourcentage d'équilibre des Systèmes Fonctionnels du corps humain

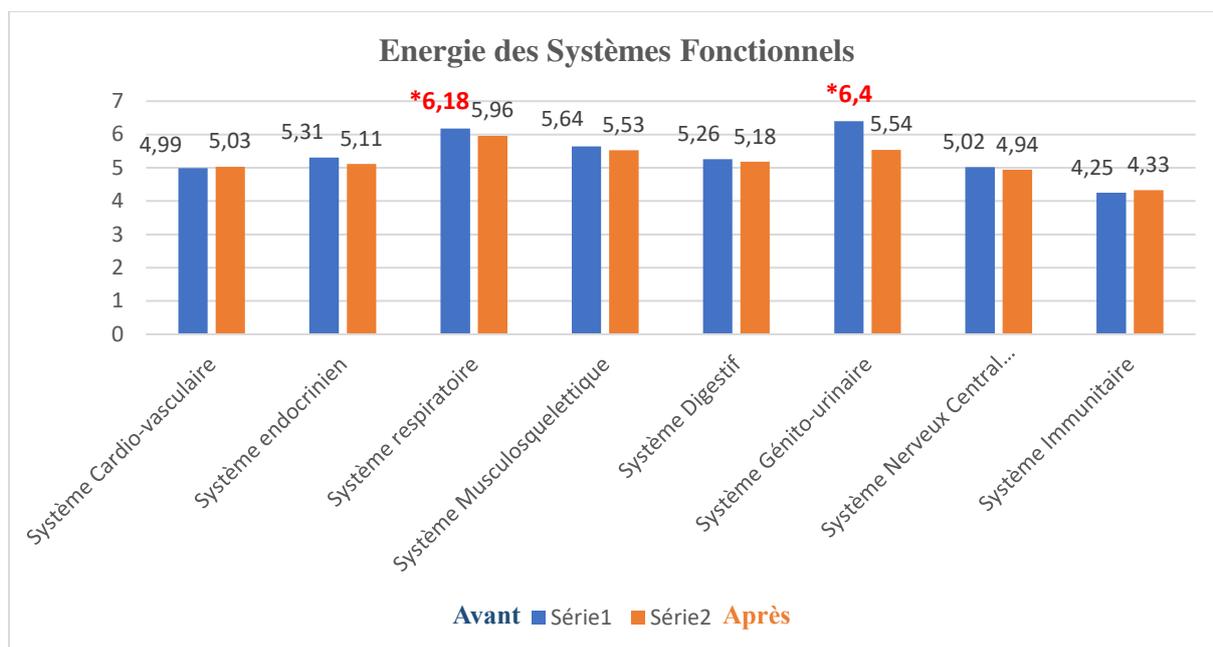

Energie : Les Systèmes Fonctionnels conservent statistiquement une énergie équivalente avant et après avoir été assis 1H sur le disque « Cyma-Seat ». * On note que le « Cyma-Seat » a eu une action d'harmonisation de l'énergie pour le système Génito-Urinaire (énergie passée de 6,40 J à 5,54 Joules (10^{-2}) et sur le système Respiratoire (énergie passée de 6,18 J à 5,96 Joules (10^{-2}). Rappel : La norme est comprise entre 4 et 6 Joules (10^{-2}).

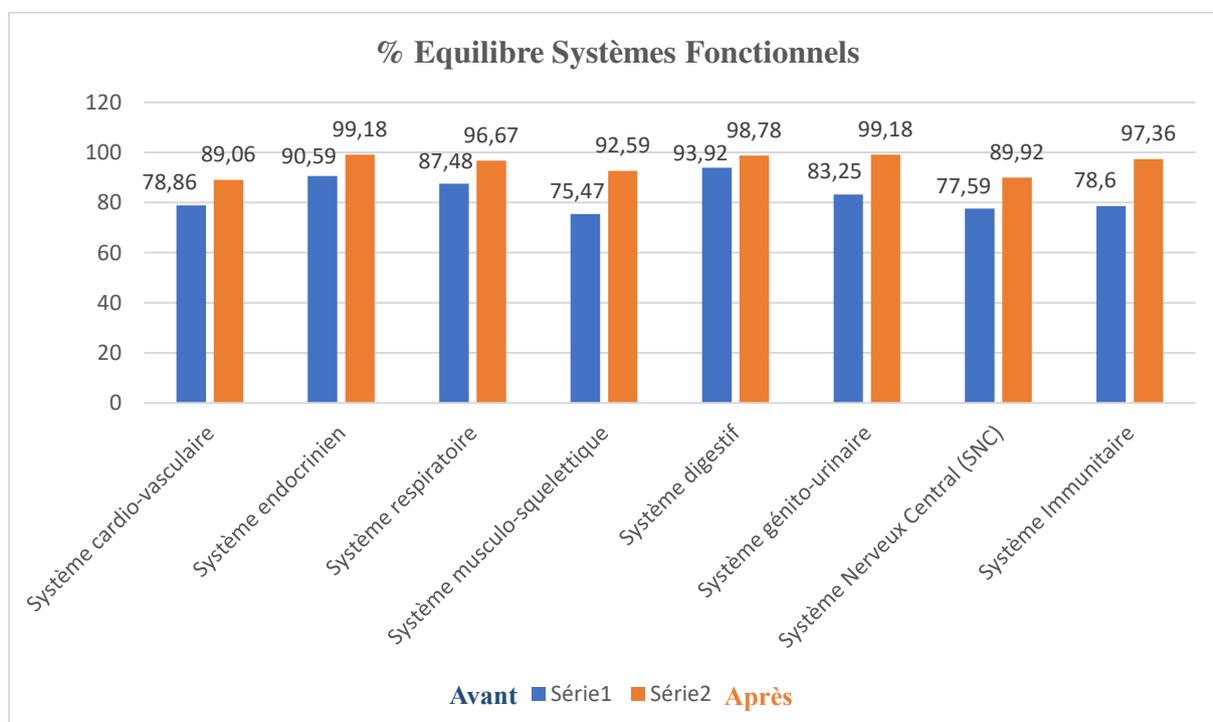

L'action des fréquences du disque « Cyma-Seat » fait augmenter statistiquement tous les pourcentages d'équilibre dans les Systèmes Fonctionnels, favorisant l'harmonisation énergétique organique globale.

IV) Cas N° 4

Mesures Janvier 2025

Mesures énergétiques en unités Joules (10^{-2}) des 12 Méridiens (MTC).

Norme = entre 4 et 6 joules (10^{-2})

Mesures du pourcentage d'équilibre des 12 Méridiens (action du SNA).

Norme optimale = entre 90% et 100%

A) Analyse de l'action du « Cyma-Seat » sur l'énergie et le pourcentage d'équilibre des 12 Méridiens d'acupuncture


Rappel: Le tableau récapitulatif présenté dans cette étude contient les moyennes des 732 paramètres étudiés dans le cadre de cette étude scientifique.

Mesures Méridiens	AVANT Energie en Joules (10^{-2})	1H APRES Energie en Joules (10^{-2})	AVANT Pourcentage équilibre	1H APRES Pourcentage équilibre
YIN				
Poumons	5,07	4,95	92%	96%
Rate	5,71	5,64	89%	98%
Cœur	5,06	5,10	78%	99%
Reins	5,72	5,75	87%	96%
Péricarde	5,51	5,41	93%	99%
Foie	*6,52	*5,61	78%	90%
YANG				
Gros Intestin	5,89	5,69	81%	96%
Estomac	5,27	5,05	-	-
Intestin Grêle	5,13	4,80	91%	95%
Vessie	*6,41	*5,28	88%	94%
Triple Réchauffeur	5,65	4,81	90%	99%
Vésicule Biliaire	5,01	4,95	-	-


**** = Harmonisation de l'énergie qui était en augmentation dans le Foie et la Vessie.**

Energie : Les méridiens d'acupuncture conserve statistiquement une énergie équivalente avant et après traitement.

L'action du disque « Cyma-Seat » fait augmenter les pourcentages d'équilibre fonctionnel des méridiens.

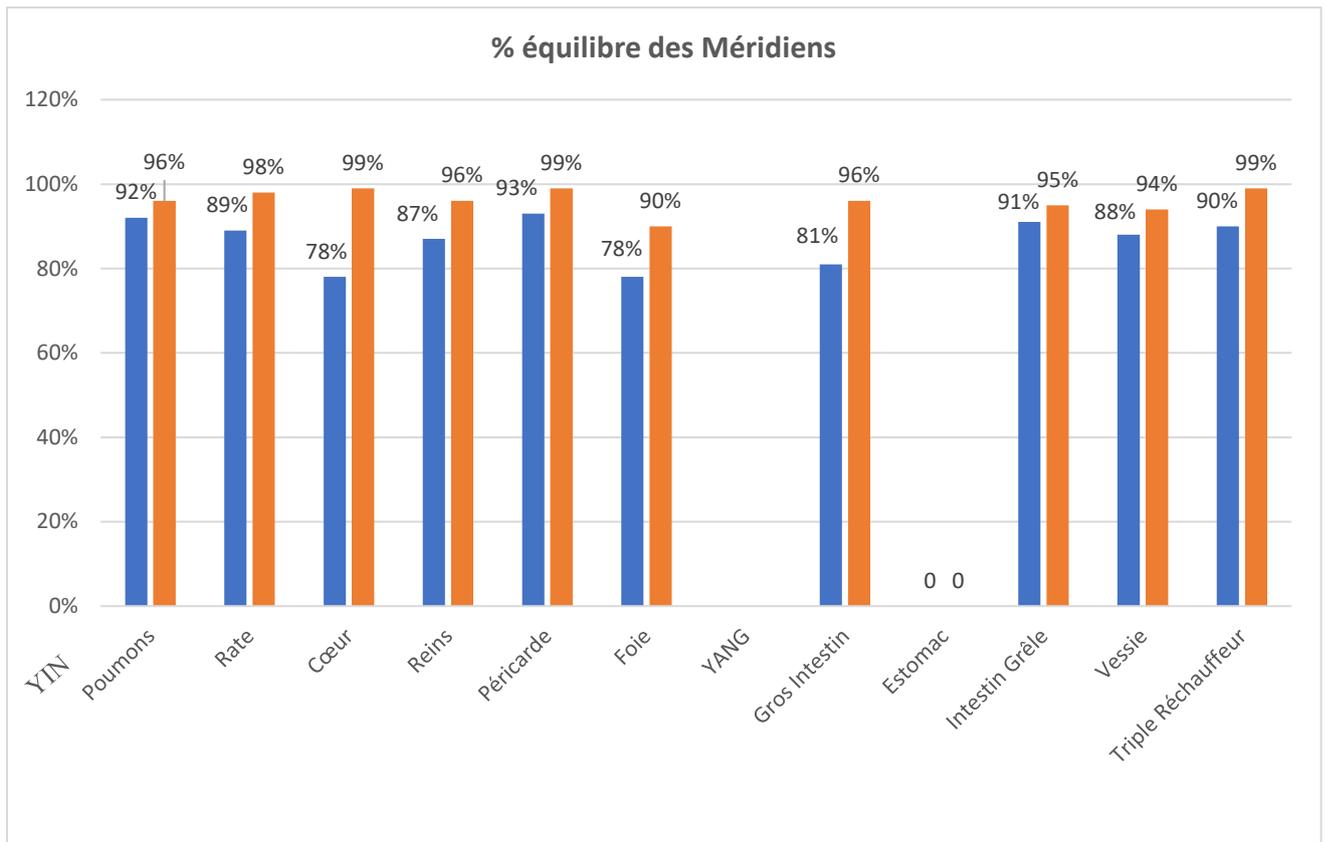


L'action des fréquences du disque « Cyma-Seat » fait augmenter statistiquement tous les pourcentages d'équilibre des Méridiens favorisant la santé globale.

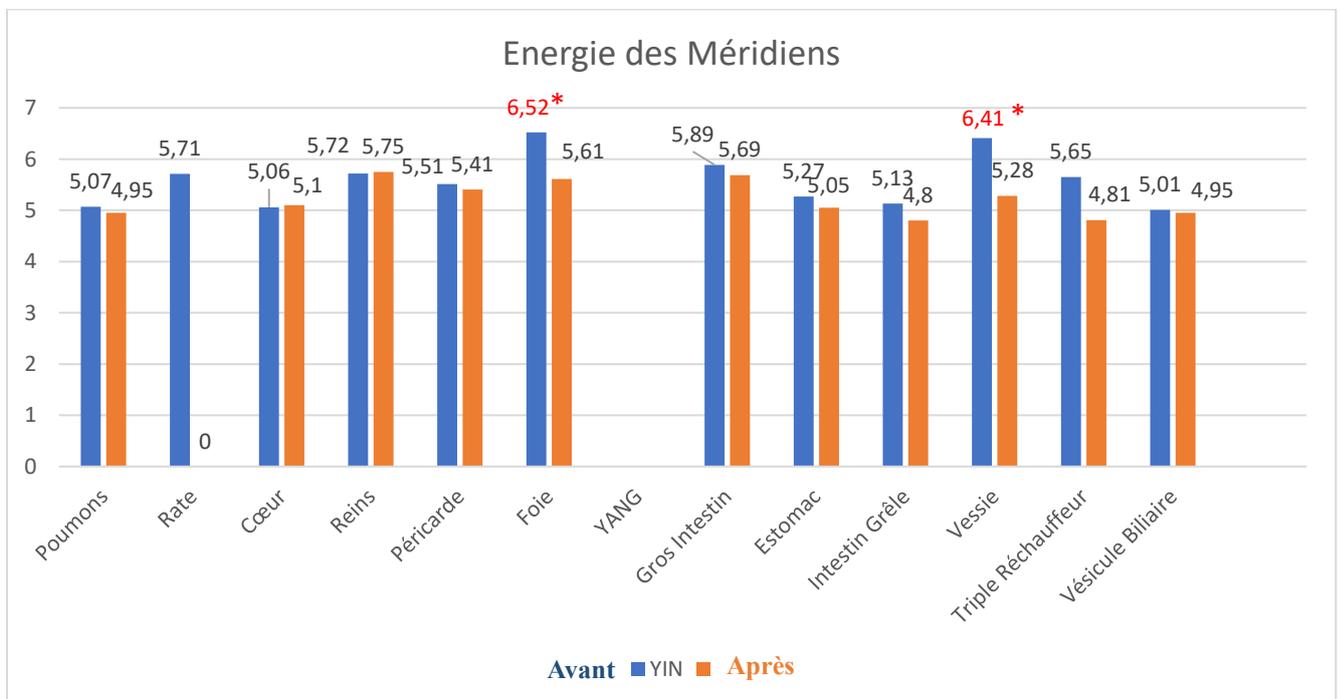

**** = Harmonisation de l'énergie qui était en augmentation dans le Foie et la Vessie.**

Energie : Les Méridiens conservent statistiquement une énergie équivalente avant et après avoir été assis 1H sur le disque « Cyma-Seat ».

B) Analyse de l'action du « Cyma-Seat » sur l'énergie et le pourcentage d'équilibre des Systèmes Fonctionnels du corps humain

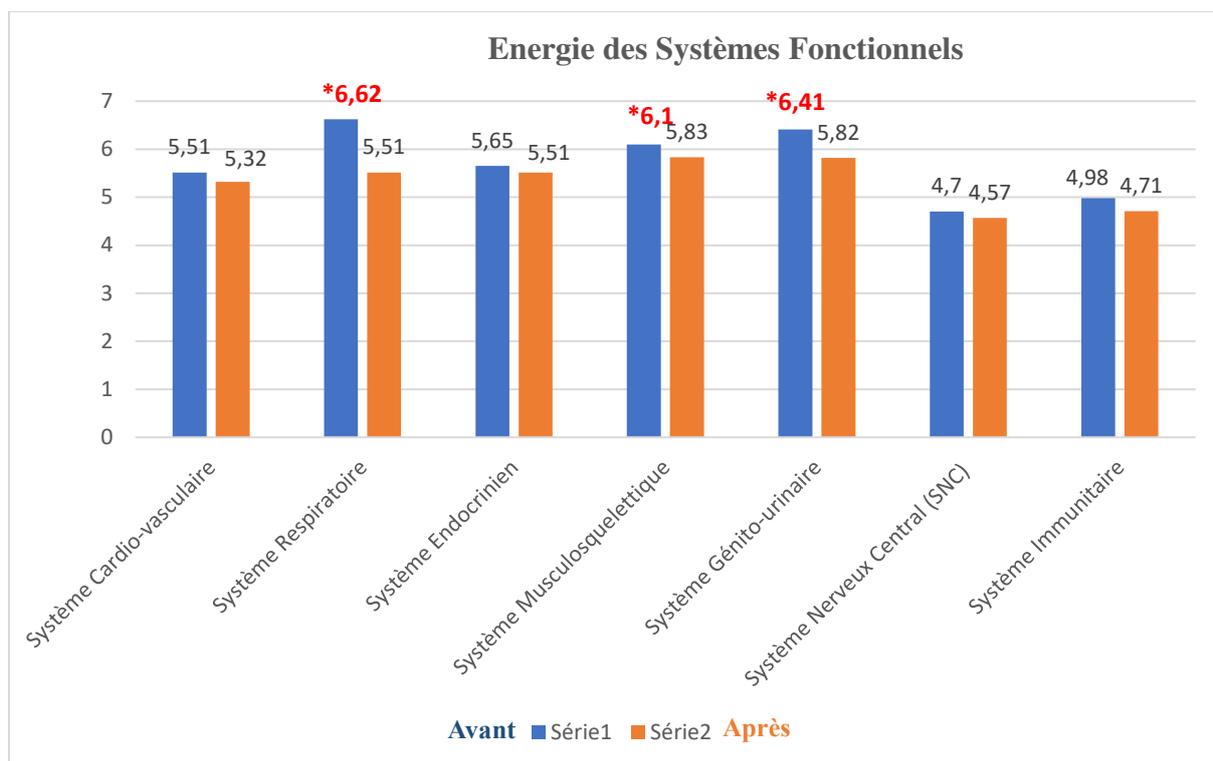


L'action des fréquences du disque « Cyma-Seat » favorise la régulation énergétique de tous les systèmes fonctionnels du corps humain. Statistiquement, l'énergie reste constante dans tous les systèmes fonctionnels.

* Mais il est à noter que le « Cyma-Seat » a eu une action d'harmonisation de l'énergie pour :

- le système **Respiratoire** qui avait une énergie trop élevée = 6,62 J et qui est passée à 5,51 Joules (10^{-2}). Rappel : la norme de l'énergie vitale est comprise entre 4 Joules (10^{-2}) et 6 Joules (10^{-2}).

- le système **Musculosquelettique** (énergie trop élevée qui est passée de 6,62 J à 5,51 Joules (10^{-2}). Rappel : la norme de l'énergie vitale est comprise entre 4 Joules (10^{-2}) et 6 Joules (10^{-2}).

- le système **Génito-Urinaire** qui avait une énergie en augmentation, 6,40 Joules (10^{-2}) qui est revenue dans la norme à 5,54 Joules (10^{-2}). Rappel : la norme de l'énergie vitale est comprise entre 4 Joules (10^{-2}) et 6 Joules (10^{-2}).

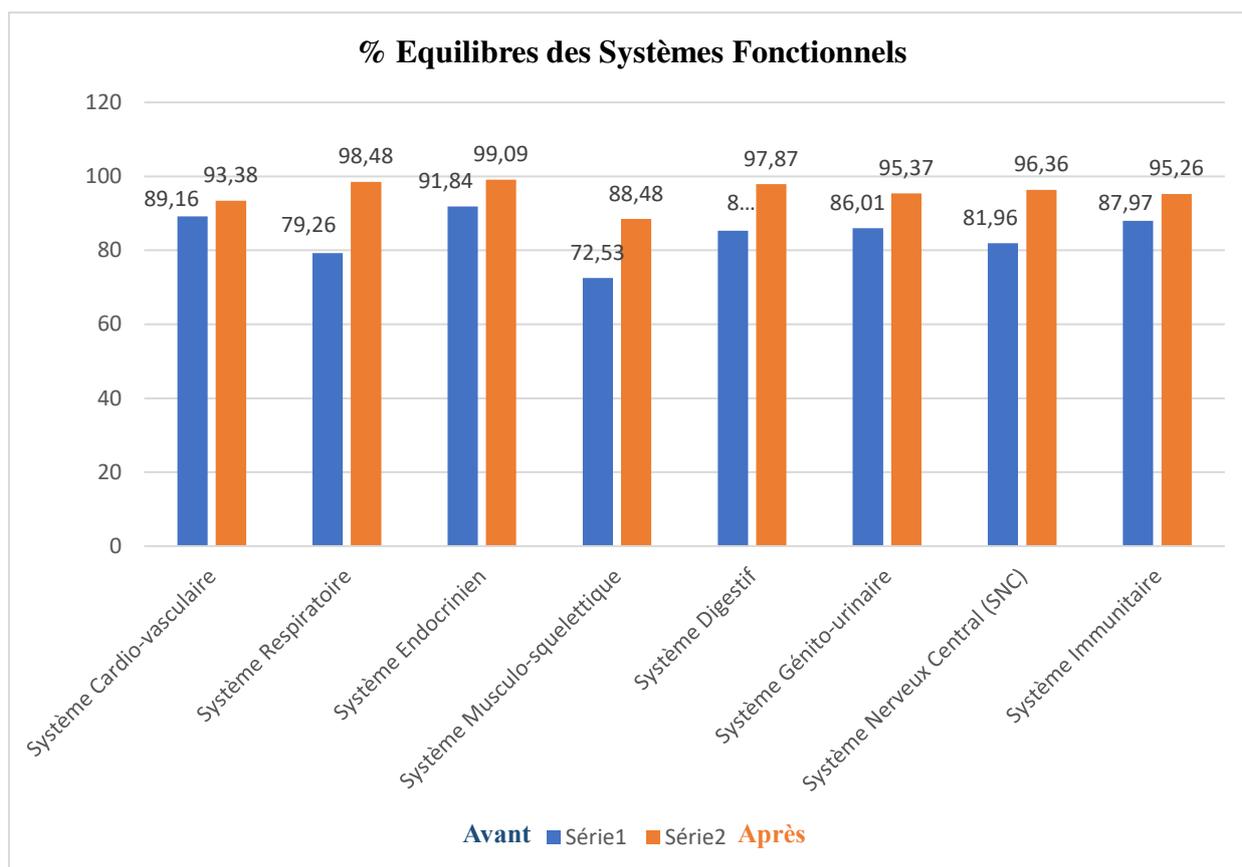

L'action des fréquences du disque « Cyma-Seat » fait augmenter statistiquement tous les pourcentages d'équilibre dans les Systèmes Fonctionnels, favorisant l'harmonisation énergétique organique globale.